


時刻: 14:56:02, 04/04/2011


1

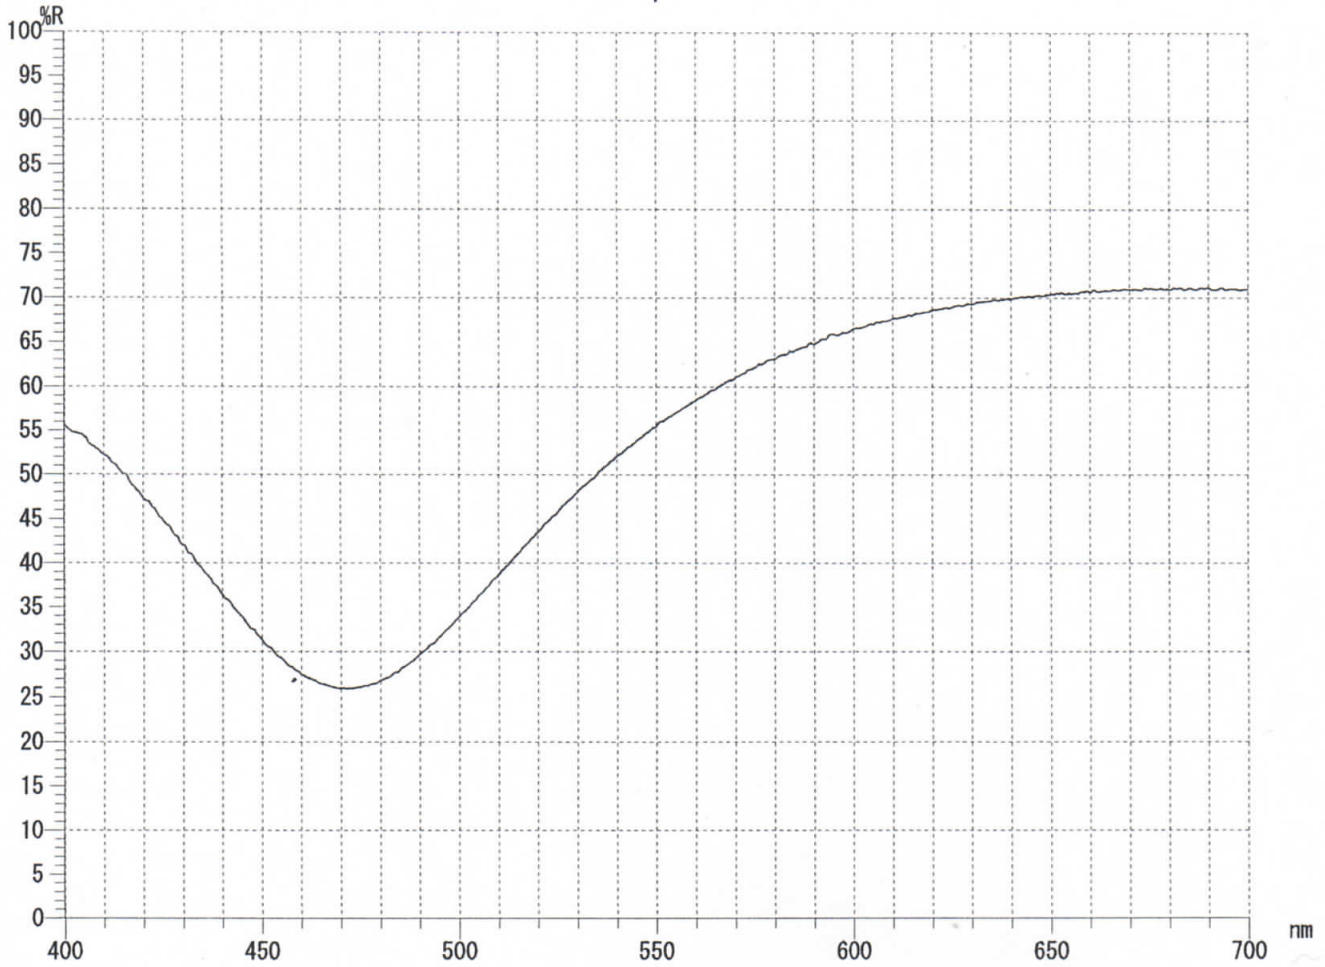

サンプル: 1  
 ファイル名: 14:52:35, 04/04/2011  
 分析日時: Administrator  
 オペレータ: Administrator  
 コメント:

光度計  
 モデル: U-3000形分光光度計  
 シリアル No.: 0838-015  
 ROM Ver.: 2520 10

装置条件  
 測定モード: 波長スキャン  
 データモード: %R  
 開始: 700.00 nm  
 終了: 400.00 nm  
 スキャンスピード: 120 nm/min  
 サンプル間隔: 0.20 nm  
 スリット: 2 nm  
 ホルム電圧: 自動制御  
 光源切換モード: 自動切換  
 光源切換波長: 340.00 nm  
 ヘースライン設定: ユーザ 2  
 高分解能測定: Off  
 セル長: 10.0 mm

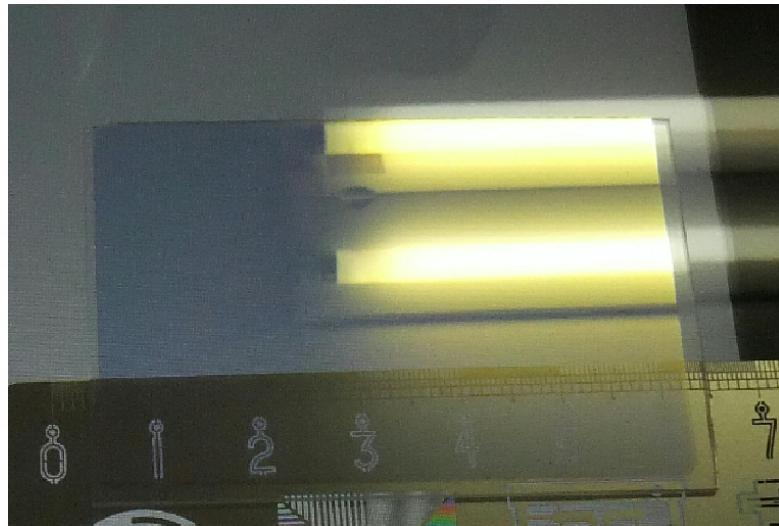

データリスト							
nm	%R	nm	%R	nm	%R	nm	%R
700.00	71.0	690.00	71.1	680.00	70.9	670.00	70.9
660.00	70.6	650.00	70.3	640.00	69.8	630.00	69.2
620.00	68.6	610.00	67.6	600.00	66.5	590.00	64.7
580.00	63.1	570.00	61.0	560.00	58.5	550.00	55.5
540.00	52.1	530.00	48.0	520.00	43.5	510.00	38.7
500.00	33.9	490.00	29.7	480.00	26.8	470.00	25.9
460.00	27.5	450.00	31.3	440.00	36.3	430.00	42.0
420.00	47.3	410.00	52.2	400.00	55.6		