



1

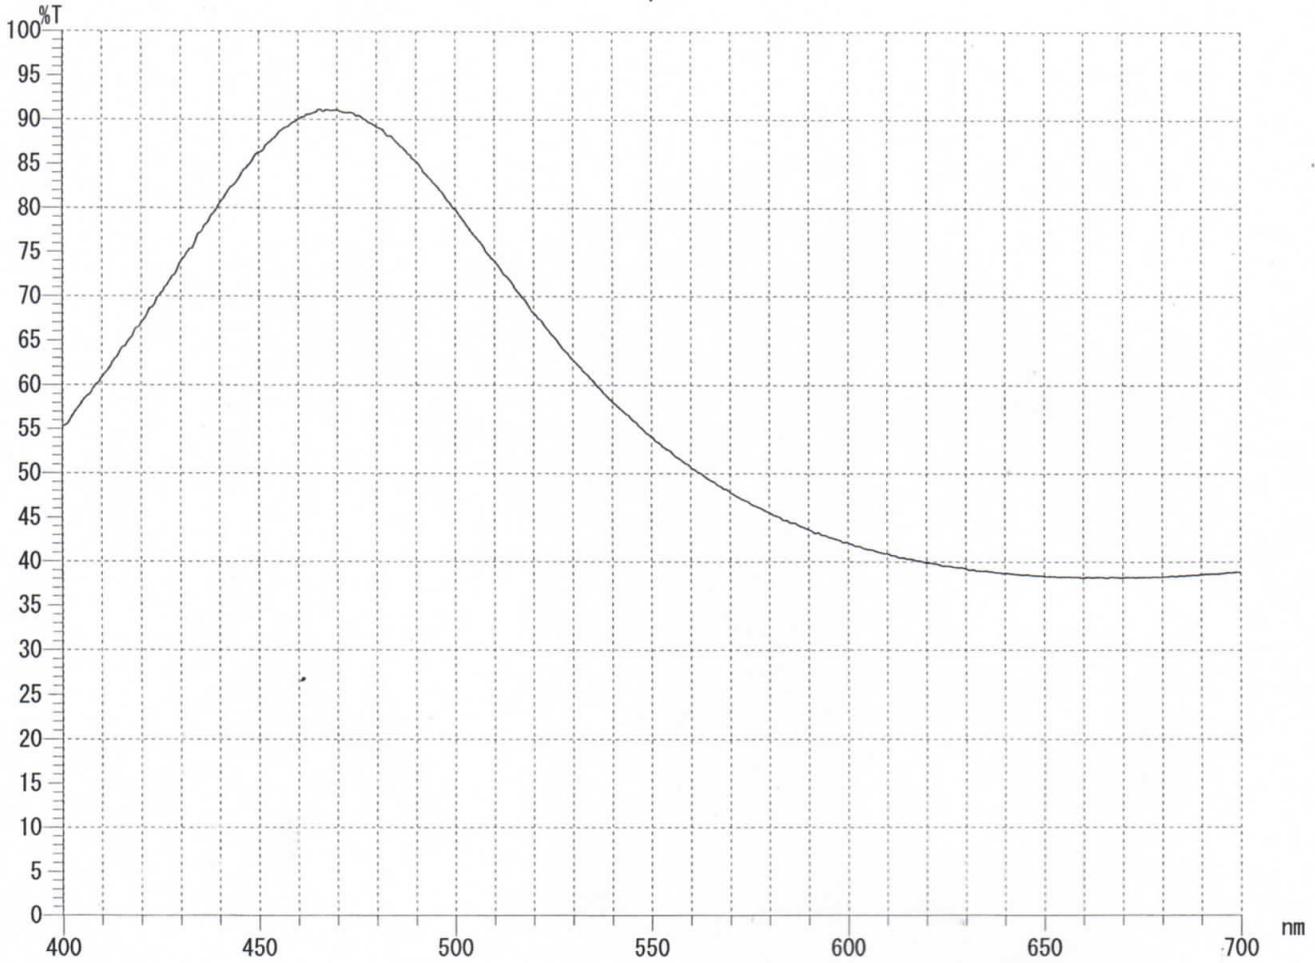

サンプル: 1  
 ファイル名:  
 分析日時: 11:02:46, 01/25/2011  
 オペレータ: Administrator  
 コメント:

光度計  
 モデル: U-3000形分光光度計  
 シリアル No.: 0838-015  
 ROM Ver.: 2520 10

装置条件  
 測定モード: 波長スキャン  
 データモード: %T  
 開始: 700.00 nm  
 終了: 400.00 nm  
 スキャンスピード: 120 nm/min  
 サンプル間隔: 0.20 nm  
 スリット: 2 nm  
 ホトマル電圧: 自動制御  
 光源切替モード: 自動切換  
 光源切替波長: 340.00 nm  
 ベースライン設定: ユーザ 1  
 高分解能測定: Off  
 セル長: 10.0 mm

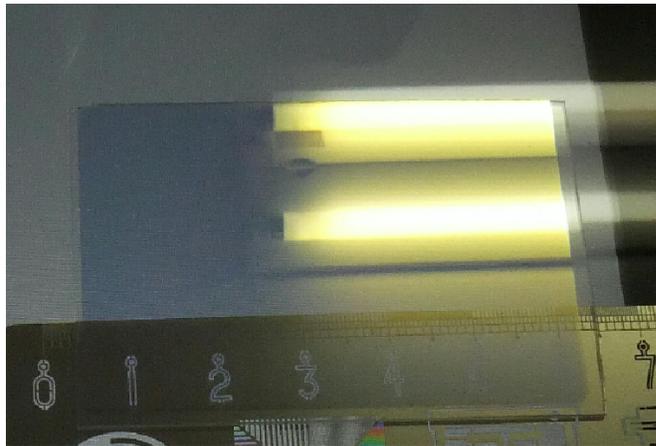

nm	%T	nm	%T	nm	%T	nm	%T
700.00	38.8	690.00	38.5	680.00	38.2	670.00	38.1
660.00	38.1	650.00	38.3	640.00	38.7	630.00	39.2
620.00	39.8	610.00	40.9	600.00	42.1	590.00	43.6
580.00	45.6	570.00	47.9	560.00	50.7	550.00	54.1
540.00	58.2	530.00	62.8	520.00	68.1	510.00	74.0
500.00	79.9	490.00	85.3	480.00	89.2	470.00	91.1
460.00	90.0	450.00	86.3	440.00	80.5	430.00	73.9
420.00	67.0	410.00	60.8	400.00	55.3		